

CT 球管采购合同

甲方：商丘市中医院

乙方：国药控股创服医疗技术（河南）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械管理条例》等有关规定,现就甲方向乙方购买医疗设备零备件有关事项,经甲乙双方友好协商签订合同如下:

第一条:甲方采购的备件内容和合同价格

甲方向乙方购买的零备件及附件、规格型号、数量及金额如下表:

零备件名称	规格型号	数量	单位	单价	小计
球管及安装调试	D3703T	1	支	1395000	1395000.00
合计	人民币: (大写) 壹佰叁拾玖万伍仟圆整 ¥: 1395000.00 元				

上述合同已包括产品设计、材料、制作、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用前及保修期内服务与备用物件、培训甲方人员等各项费用,甲方无须向乙方支付本合同之外的其他任何费用。

第二条:零备件交付和验收

1、乙方在收到甲方通知后 72 小时内将合同内货物运抵甲方指定位置并安装调试完毕。

2、验收标准

质量与技术标准符合国家法律法规规定的标准和合同要求。

第三条、货款的结算

1、结算依据:乙方出具采购合同和增值税普通发票、甲方出具的验收报告,设备的入库,出库调拨单。

2、付款方式: 甲方将合同全款以电汇或支票方式在合同内货物安装验收合格后交付乙方。

第四条、质量保证:

1、乙方提供的产品(含零部件、配件等)必须为全新未使用过的,生产厂家、质量、规格、型号及技术指标符合国家标准和合同规定的要求,不得侵害他人知识产权。

2、乙方承诺,凡按本合同销售的球管应达到下表中规定的病人量/时间(先到为准)。

球管料号	完全保证扫描秒次或病人量/时间(先到为准)
D3703T	12个月

自安装之日起,如在完全保证扫描秒次(病人量)/时间(先到为准)内出现无法使用的故障,乙方将免费为甲方更换新球管,直至乙方提供的全部球管累计扫描秒次(病人量)/时间达到完全保证扫描秒次(病人量)/时间为止。

3、乙方承诺本合同销售的球管符合GE公司全球生产工艺方面的要求和产品在产地装运时的产品说明书和/或使用说明书中的质量标准,没有任何材料和使用上的缺陷。

第五条乙方的违约责任

1. 供应商不能交货的,甲方不予支付货款,乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款20%的违约金。逾期交货的,按要求向甲方偿付货款每日1%的违约金,并承担甲方因此所受的全部损失。

2. 乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合国家标准和合同规定的,乙方无条件退货,并承担由此产生的所有实际费用。

3、如因产品质量或属假冒伪劣造成甲方损失的,乙方除应甲方返还已收款项外,还应向甲方赔偿该产品造成的一切损失同时支付产品总价20%的违约金,并承担相应的法律责任。

第六条甲方的违约责任

1、甲方违反合同规定拒绝接货,应承担由此对乙方造成的损失。

第七条争议的解决

1、甲乙双方任何一方因不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任



2. 因设备质量问题发生争议, 可由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定, 费用由违约方承担

3. 执行本合同发生纠纷, 双方应及时协商解决, 协商不成时, 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效


1. 本合同一式四份, 甲方三份、乙方一份, 具备同等法律效力。

2. 本合同由双方加盖合法公章后, 自签订之日起生效, 未尽事宜, 双方友好协商解决。

甲方: 商丘市中医院

地址: 河南省梁园区团结东路 38 号

日期: 2024.4.9

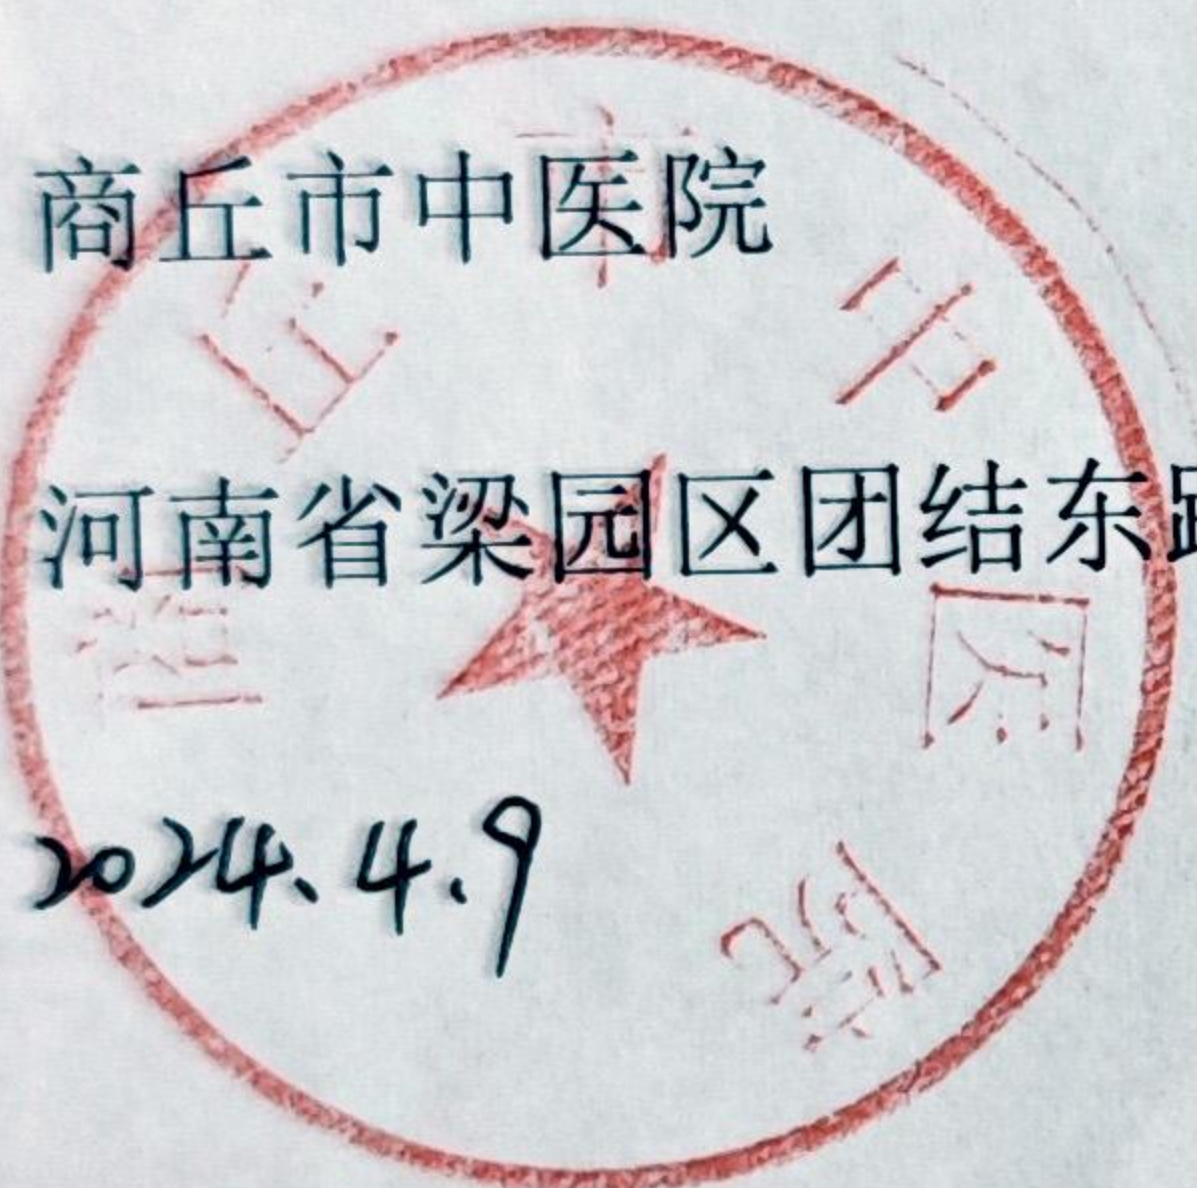

乙方:

签字:

日期:



4101056049513

